

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Dzieci, Ogólnego i Kardiochirurgii.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

II.

Zapytanie do pakietu nr 4, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści taśmy o następujących parametrach:

Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w kształcie i wielkości. Zaprojektowana jako zamiennik kosmetyczny, proteza jądra jest wskazana dla pacjentów, którzy cierpią z powodu agenezji jądra lub gdy jądro zostało usunięte operacyjnie ze względu na szereg schorzeń.

Jest to pełny implant z elastomeru niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, który jest bardzo podobny do naturalnego jądra. Wypełnienie protezy jądra stanowi substancja stała, elastyczna, nie rozlewająca się i nie wyciekająca podczas nakłuwania igłą. Proteza jest sterylna i pozbawiona pirogenów w systemie pakowania z podwójnym owijaniem.

Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym folią termokurczliwą,

Materiał zszywający przechodzący przez dowolny punkt protezy, eliminuje ryzyko wycieków.

Rodzaje implantów

MODEL	A (mm)	B (mm)	Objętość
T-Small [mały]	31	23	9 ml
T-Medium [średni]	37	28	15 ml
T-Large [duży]	42	32	23 ml
T-XLarge [ekstra duży]	47	34	34 ml

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

IX.

Pytanie1 do Zadania nr 4 lp.1,2

Czy zamawiający dopuści wysokiej endoprotezy jądra renomowanego producenta wg poniższej specyfikacji:

Lp.1 Endoprotezy jądra z silikonu do wypełnienia solą fizjologiczną w rozmiarach do wyboru przez zamawiającego: XS 21m x27mm, S 26mm x 32mm, M 29mm x 41mm, L 32mm x 47mm, XL 32mm x 51mm, pakowane pojedynczo sterylnie?

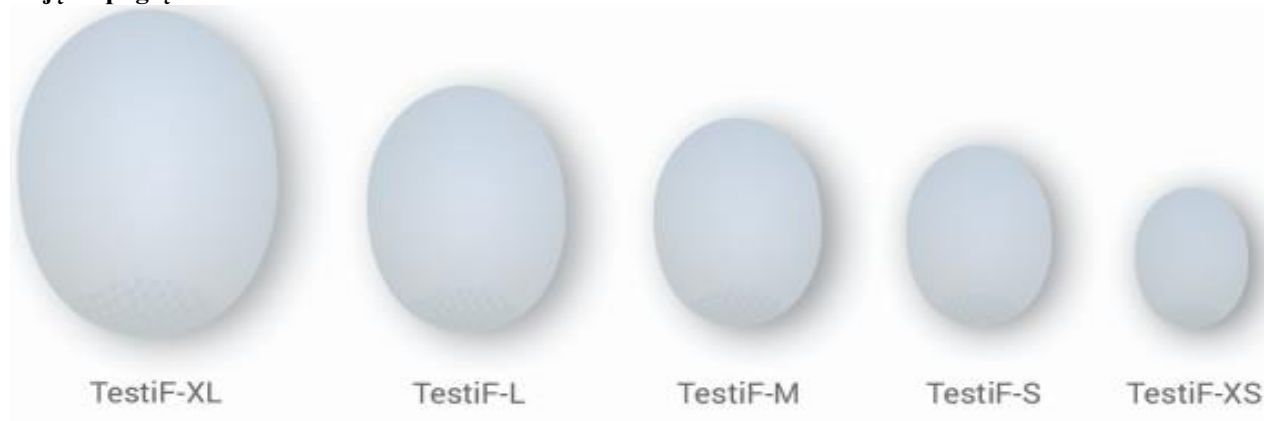
Zdjęcie poglądowe endoprotezy



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Lp.2

Endoprotezy jądra z litego silikonu o kształcie anatomicznym, w rozmiarach do wyboru przez zamawiającego: XS 21m x 27mm, S 26mm x 32mm, M 29mm x 41mm, L 32mm x 47mm, XL 32mm x 51mm, pakowane pojedynczo sterylnie?

Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie w/w odpowiedzi. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **17.07.2019r. godz. 10:00** Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia **17.07.2019 r. godz. 10:30** w Budyńku Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

Krzysztof Bałata - Dyrektor